

Google Fit ご利用手順


注意

- 歩数送信/歩数同期済みの場合、当日中のGoogle Fitへのデバイス(歩数測定機器変更)はできません。
翌日0:00以降、Google Fitへデバイス(歩数測定機器変更)ができます。
 - Google Fitへのデバイス(歩数測定機器)変更は1日1回です。
-

Google Fit 健康マイレージ

健康マイレージのアプリで Google Fit を利用する場合、下記の手順のとおり、設定を行ってください。歩数送信を行うと、当日中は測定デバイスの変更ができません。また未送信分の歩数は破棄されますので、1日の初めに測定デバイスの変更を実施することを推奨します。

1 設定を選択する

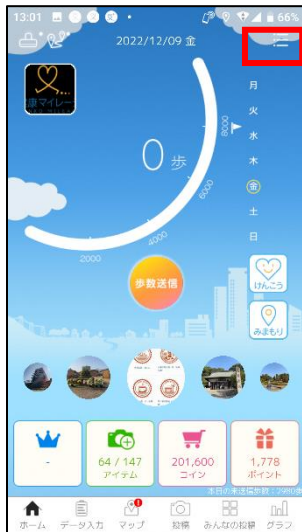


アプリホーム画面右上のメニュー画面をタップ(指先で軽く画面にタッチ)します。

2



メニュー一覧が表示されますので[設定]を選択します。

3

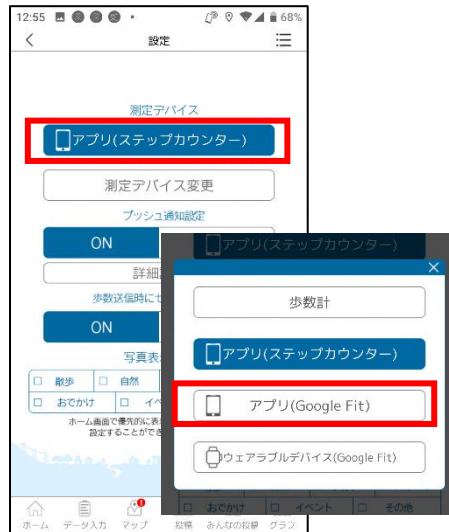

[設定]情報が表示されますので[測定デバイス]を押下し、「アプリ(GoogleFit)」を選択します。

4




未送信分の歩数が表示されます。測定デバイスを変更すると、未送信分の歩数は破棄されてしまいます。

問題なければ[OK]を押下します。

※既に当日歩数を送信している方は、当日中は測定デバイスを変更することができません。

5

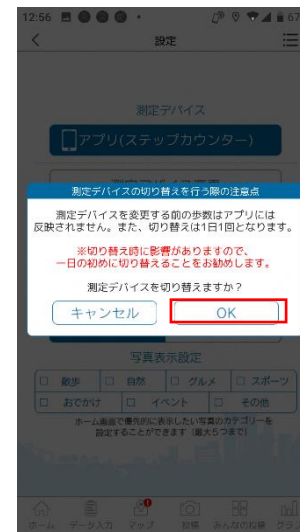

「Google Fit連携をON設定にする前の歩数はアプリには反映されません。切り替えは1日1回となります。」

Google Fitのインストールをされていない方はこちら

6

Google Fitのインストール済みの方はこちら

8

Google Fit 健康マイレージ

健康マイレージのアプリで Google Fit を利用する

6



「OK」を選び
[google ストア]へ移動します。

7



[インストール]をタップし、インストールが完了後「開く」を選択します。
アプリを開き利用するアカウントを選択後、基本情報の設定を行います。
(スキップせずに項目の入力をお願いいたします。)

[google ストア]にて [Google Fit]をインストールします。

8



ご利用のアカウントを選択します。「許可」を選択します。

9



Google Fit 健康マイレージ

健康マイレージのアプリで Google Fit を利用する

10



上記の様に、測定デバイスが、「アプリ (Google Fit) 」になっていれば設定完了です。